

FOREO

源自瑞典



IRIS™ 2

艾丽丝2代眼部按摩仪

在线手册

完整版使用说明书

开始使用

恭喜您购买到IRIS™ 2 眼部按摩仪，成功开启了焕活“睛”采的第一步。当您在舒适的家中准备享受高端眼部护理科技所带来的好处之前，请先仔细阅读本使用说明书。

使用前**请阅读所有指南**并仅按照本说明书中的指定用途使用本产品。

⚠ **警告：**请勿对产品经行任何改装。



IRIS™ 2 概述

IRIS™ 2 是一款快速、有效、超卫生的眼部按摩仪，FOREO将独家T-Sonic™ 与亚洲古老的按摩手法相结合，达到舒缓按摩的目的。

传统的手指叩击穴位的动作可以帮助减少黑眼圈，使疲惫的眼睛恢复活力。它也有助于缓解面部肌肉因眼睛疲劳而产生的紧张。T-Sonic™ 脉动为眼部区域提供温和的按摩，结合眼部护肤品有助于提亮和紧致眼周，减少鱼尾纹和细纹的出现，同时缓解眼睛疲劳。IRIS™ 2 还可以增强眼部护肤品中活性成分的吸收，使其深入肌肤，达到最佳效果。

了解你的IRIS™ 2

人体工学设计

15°弧度曲线，完美贴合眼周，适用各种脸型。

卫生亲肤硅胶

天鹅绒般柔软，不含双酚A和邻苯二甲酸盐，不易滋生细菌。

+/- 键

2种模式，每种模式4档调节。同时按下+/- 键可锁定仪器，旅途之中更安心。

通用电源按钮

开关按摩仪，关闭T-Sonic™ 垂直透肤声波脉动。

智能提醒

内置计时器，每30s提醒更换眼部进行护理。

防滑触点

持握舒适不易滑落，让你轻松恢复眼部活力。

便携防水

IP68级防水，轻巧易携带。

指示灯

电量过低时，红光闪烁提醒充电，白灯常亮表示充满。



USB充电线

随时随地为设备充电。

如何使用IRIS™ 2:



步骤一

洗净并擦干面部, 然后在眼周涂抹护肤品。*



步骤二


长按通用电源按钮3秒钟开启设备。您可以通过 + / - 键调节按摩强度。再次按下通用电源按钮即可关闭T-Sonic™ 震动。将设备抵在眼周, 从中心向外, 按摩眼睛的上部和下部。

注意: 当您首次开箱时仪器可能处于锁定状态 - 同时按下“+”“-”键3秒钟即可解锁。当指示灯闪烁时表明您的设备已解锁。



步骤三

每只眼睛按摩30秒后, 内置计时器提示后换另一侧眼睛再次按摩。1分钟后, 护理结束。建议每天使用两次。**

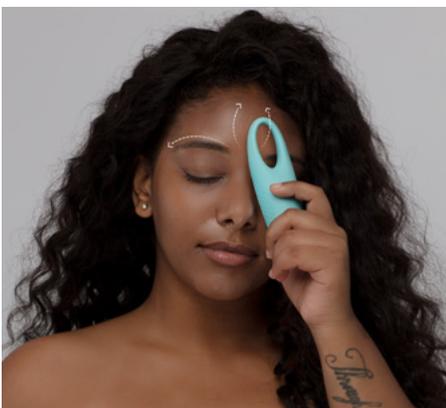

专业小贴士:

你也可以将IRIS™ 2放在额头上放松面部肌肉紧张点。

* 这不是必须的。您也可以单独使用IRIS™ 2 而不使用任何眼部护肤品。

** 有按钮的一面应朝向你的脸。IRIS™ 2 会在3分钟后自动关闭。

模式选择

1. 按下通用电源按钮开启IRIS™ 2。首次开启时即为SPA模式。
2. 再次按下通用电源按钮变为舒压模式。
3. 再按一次即可关闭IRIS™ 2。

您可以通过“+”“-”键调节舒压模式和SPA模式的强度。

清洁IRIS™ 2

每次使用后务必彻底清洁设备。用肥皂和温水清洗设备。用无绒布或毛巾轻轻擦干，或自然晾干。我们建议使用FOREO的硅胶清洁喷剂喷洒设备，并用温水冲洗，以获得最佳效果。

注意：切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁产品，因为它们可能会刺激皮肤并损坏硅胶。

重要信息

为了最佳安全性：

- 如果您有严重的眼部疾病或任何皮肤问题，请在使用前咨询医生。
- 使用IRIS™ 2应该是舒适的-如果你感到不适，立即停止使用并咨询医生。
- IRIS™ 2仅适用于眼下区域和眉骨，请勿用于眼睑或眼球。
- 出于卫生原因，我们不建议您与他人共享IRIS™ 2。
- 请避免将IRIS™ 2置于阳光下直射或置于极端高温环境或沸水中。
- 当儿童或生理、心理不健全的人使用时，或在其附近使用时，应给予适当的监督和指导。
- 如果本产品出现任何损坏，请停止使用。本产品不含可维修零件。
- 仅在本手册所述的预期用途下使用本产品。如果您没有找到特定问题的答案，或者您对设备的操作有任何其他问题，请访问www.foreo.com。

故障排除

如果IRIS™ 2出现下列情况，您可以采取相应措施进行处理

当您按下通用电源按钮时IRIS™ 2无反应：

- 可能电池耗尽，请使用USB充电线充电2小时，直至充满。然后，按下通用电源按钮重新启动IRIS™ 2。
- 设备被锁定，请同时按下+/-键，解锁设备。

IRIS™ 2无法正常关闭/界面按钮无反应时：

- 这可能是微处理器出现了暂时故障，请连接USB充电线或按住通用电源按钮重启。

如果IRIS™ 2连接USB充电线时指示灯不闪烁：

- 电池已满。可使用多达150次。
- 电池完全耗尽，需要几分钟识别USB充电线。
- 未正确连接，请检查电源插座 / USB接口和充电孔。

如果IRIS™ 2不慎落水或打湿充电孔应如何处理：

- IRIS™ 2完全防水，充电孔处完全密封，您只需擦干即可正常使用。

质保条款与条件

注册质保

通过 foreo.com/产品注册以激活2年质保，获得更多信息。

2年质保

FOREO产品的质保时间为自购买之日起2年，任何正常使用时因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题，但不包括由于长期使用造成的正常外观磨损或由于意外，错误操作或疏忽造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品(或其附属配件)造成的损坏也不在质保范围。

如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知FOREO，FOREO经过售后服务中心确认和/或检测后，将免费为您更换产品。质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理凭证。为了让您的产品质保有效，请在质保期内妥善保存原始购买发票和质保信息。

若需申请质保，请先登陆您在www.foreo.com网站上的账户，然后选择质量索赔。您需自行承担运费。此举是对消费者法律权利的补充，并不影响消费者任何权益。

废弃处理方法

废旧电子设备的废弃处理方法(在欧盟或其他具有垃圾分类处理系统的欧洲国家适用)。



该设备不可作为生活垃圾进行处理，而应被带到专门回收电器和电子设备的收集点。通过确保正确地处理该设备，可有助于防止由于采用不恰当的废弃处理方式而造成的对环境和人类健康的潜在危害。材料回收也有助于保护自然资源。


更多产品回收信息，请联系当地的生活垃圾处理服务站或产品购买地。

电池拆卸

注意：这个过程是不可逆的。打开设备将使其质保失效。只有在设备准备好处理时才能执行此操作。

由于此设备包含锂离子电池，因此必须在处理前取出电池，不得丢弃进生活垃圾中。要取出电池，请拆开硅胶外层后，沿着裂缝切开塑料外壳。接下来撬开外壳，并使用解胶剂分离出电池。然后切断电池线，按照当地环境法规处理取出电池并根据您所处地区的环保法规对其进行处理。在此过程中请戴上手套以确保您的安全。

详细图文说明：

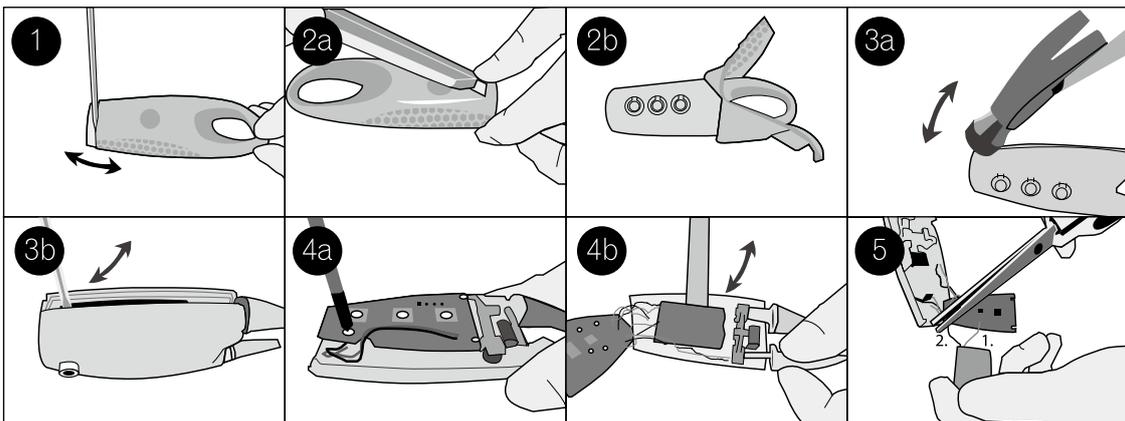

产品规格

材料:	食品级硅胶, PBT 聚合物, PC + ABS
颜色:	薄荷蓝, 樱桃红, 粉红色
尺寸:	120 x 39 x 32 毫米
重量:	71 克
电池:	锂电池200毫安 3.7伏
额定:	5伏直流电, 1瓦
使用次数:	每次充满电可使用高达150次
待机时长:	90天
频率:	183 赫兹
操作界面:	3键式
脉动频率/分钟:	高达11,000次

使用环境

温度:	5 °C~40 °C
湿度:	40%~80%
大气压力:	800~1060 hPa

存储和运输环境

温度:	-10°C~50°C
湿度:	30%~80%
大气压力:	500~1060 hPa

免责声明

产品使用者自担风险。FOREO和零售商对因使用产品直接或间接造成的任何身体或非身体的伤害或损害不承担任何责任和义务。此外, FOREO保留修改本说明并随时更改内容的权利, 且没有义务将这些修改或改变通知任何个人。

如型号发生改变, 恕不另行通知。

常见问题

基本信息

1. IRIS™ 2的包装中包含什么?

IRIS™ 2, USB充电线, 操作手册。

2.我应如何开启IRIS™ 2?

长按通用电源按钮3秒即可开启IRIS™ 2。

3.我应如何关闭IRIS™ 2?

长按通用电源按钮3秒钟即可关闭IRIS™ 2。

4.我是否可以调节强度?

IRIS™ 2 有2种模式, 每种模式4档调节。

5.我如何切换模式？

按下通用电源按钮开启IRIS™ 2。首次开启时即为SPA模式。再次按下通用电源按钮变为舒压模式。再按一次即可关闭IRIS™ 2。

6.我应如何使用IRIS™ 2？

洗净并擦干面部，而后在眼周涂抹护肤品。长按通用电源按钮3秒钟开启设备。您可以通过 + / - 键调节按摩强度。再次按下通用电源按钮即可关闭T-Sonic™ 震动。将设备抵在眼周，从中心向外，按摩眼睛的上部和下部。每只眼睛按摩30秒后，内置计时器提示后换另一侧眼睛再次按摩。1分钟后，护理结束。

7.我应多久使用一次IRIS™ 2？

在您眼部感觉到疲劳时，您可随时随地使用IRIS™ 2，搭配眼霜或眼精华使用效果更佳。建议每天使用两次。

8.我应如何清洁IRIS™ 2？

每次使用后务必彻底清洁设备。用肥皂和温水清洗设备。用无绒布或毛巾轻轻擦干，或自然晾干。我们建议喷洒FOREO硅胶清洁剂，并用温水冲洗，以获得最佳清洁效果。切勿使用含有酒精、汽油或丙酮的清洁产品，以免刺激皮肤或损伤硅胶。

9.我应何时为IRIS™ 2充电？

当IRIS™ 2 的充电指示灯显示红色时请及时充电。

10.如果我按下通用电源按钮后IRIS™ 2 没有反应如何处理？

可能电池耗尽，请用USB充电线充电2小时，直至充满，然后按下通用电源按钮重新启动IRIS™ 2。或是设备被锁定，请同时按下 + / - 键，解锁设备。

11.如果我的IRIS™ 2 无法正常关闭/通用电源按钮无反应时应如何处理？

这可能是微处理器出现了暂时故障，请连接USB充电线或按住通用电源按钮重启。

12.如果IRIS™ 2连接USB 充电线时指示灯不闪烁应如何处理？

电池已满。可使用多达150次。或是电池完全耗尽，需要几分钟识别USB 充电线。或是未正确连接，请检查电源插座 / USB接口和充电孔。

13.如果IRIS™ 2 不慎落水或打湿充电孔应如何处理？

IRIS™ 2 完全防水，您只需擦干即可继续使用。

©2024 FOREO AB. 版权所有

欧洲进口商和经销商: FOREO AB 地址:KARLÄVAGEN 41, 114 31 STOCKHOLM, SWEDEN

美国进口商和经销商: FOREO INC., 地址:1525 E. PAMA LANE, LAS VEGAS, NV 89119, USA

澳洲进口商和经销商: 6 PROHASKY STREET, PORT MELBOURNE, VIC,3207 AUSTRALIA.

为FOREO AB生产，由FOREO 瑞典设计研发。

WWW.FOREO.COM